

No. FZ2001436



201719002006



2017190010039号

检测报告

TEST REPORT

委托方	广东金叶科技发展有限公司
生产单位	广东金叶科技发展有限公司
样品名称	一次性使用医用口罩
型号规格	YY-L
检测类别	委托检测



广东产品质量监督检验研究院

GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

No. FZ2001436

广东产品质量监督检验研究院
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION

检测报告

TEST REPORT



报告随机号: FWN6274

第 1 页 共 5 页

样品名称	一次性使用医用口罩		样品编号	YFZ20/001436
	送样 (✓)	抽样 (✓)		
商标	天幕湾		型号规格	YY-L
委托方	广东金叶科技发展有限公司		检测类别	委托检测
委托方地址	广东省东莞市塘厦镇桥陇河东路 8 号 2 栋 5 层		产品编号/批号	—
生产单位	广东金叶科技发展有限公司		抽样单编号	—
受检单位	广东金叶科技发展有限公司		生产日期	—
抽样单位	—		样品数量	30(个)
抽样地点	—		抽样基数	—
抽样日期	—		检验地点	本部实验室
收样日期	2020 年 02 月 14 日		检验日期	2020 年 02 月 14 日~ 2020 年 02 月 21 日
检测依据	YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》			
判定依据	—			
检测结论	<p>本次委托检测共检 7 项, 所检项目符合标准的要求。</p> <p>(检验检测专用章)</p> <p>签发日期: 2020 年 02 月 21 日</p>			
备注	报告中的“—”表示此项不适用, 报告中“/”表示此项空白。			

批准:

审核:

主检:

检测 报告

TEST REPORT

第 2 页 共 5 页

序号	检测项目[单位]	标准条款	标准要求	检测结果	单项结论	备注
1	外观	4.1	口罩外观应整洁、形状完好,表面不得有破损、污渍	符合	合格	/
				符合		
				符合		
2	结构与尺寸	4.2	口罩佩戴好后,应能罩住佩戴者的口、鼻至下颌。应符合设计的尺寸,最大偏差应不超过 $\pm 5\%$	符合	合格	/
				符合		
				符合		
3	鼻夹	4.3	口罩上应配有鼻夹,鼻夹由可塑性材料制成	符合	合格	/
				符合		
				符合		
			鼻夹长度应不小于 8.0 cm	10.5cm		
			10.5cm			
10.5cm						
4	口罩带	4.4	口罩带应戴取方便	符合	合格	/
				符合		
				符合		
			每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10 N	符合		
				符合		
				符合		
5	通气阻力 [Pa/cm ²]	4.6	口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于 49	16.8	合格	/
				16.6		
				16.9		

检测 报 告

TEST REPORT


第 3 页 共 5 页

序号	检测项目[单位]	标准条款	标准要求	检测结果	单项结论	备注
6	微生物指标 非灭菌口罩	4.7	细菌菌落总数 ≤ 100 CFU/g	<20 CFU/g	合格	/
			大肠菌群：不得检出	未检出		
			绿脓杆菌：不得检出	未检出		
			金黄色葡萄球菌：不得检出	未检出		
			溶血性链球菌：不得检出	未检出		
			真菌：不得检出	未检出		
	灭菌口罩	应无菌	—			
7	环氧乙烷残留量 [$\mu\text{g/g}$]	4.8	≤ 10 (方法检出限：0.5 $\mu\text{g/g}$)	未检出	合格	/

检测报告

TEST REPORT

照片和说明

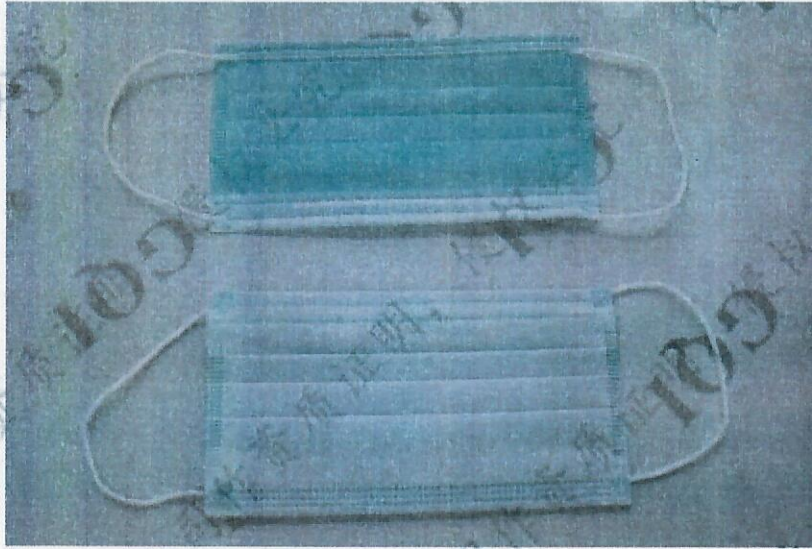

样品描述

型号规格或其它说明

YY-L

检测报告

TEST REPORT

第 5 页 共 5 页

附注:

- 1、试验地点：广州市黄埔区科学城科学大道 10 号
- 2、委托单位地址及邮编：广东省东莞市塘厦镇桥陇河东路 8 号 2 栋 5 层
- 3、检测环境条件：检测项目均在相应标准规定的条件下进行（有注明的除外）
- 4、抽样程序（如适用）：
- 5、偏离标准方法的说明（如适用）：
- 6、检测结果不确定度说明（如适用）：
- 7、分包项目及分包方（如适用）：
